

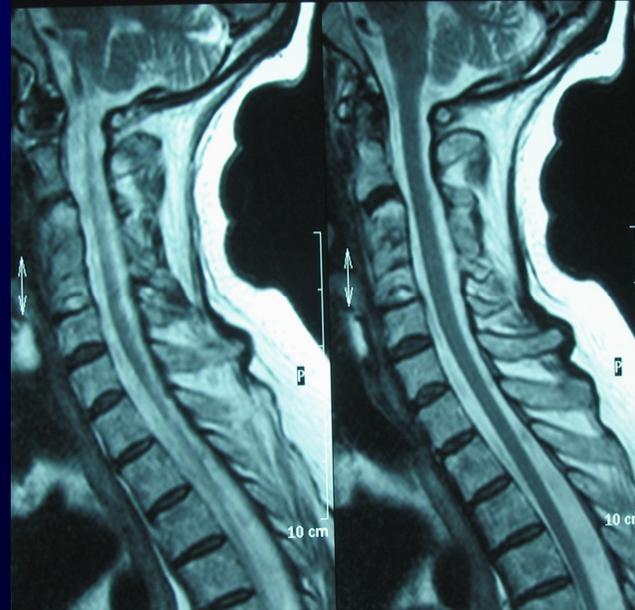


Livello dorsale: D1

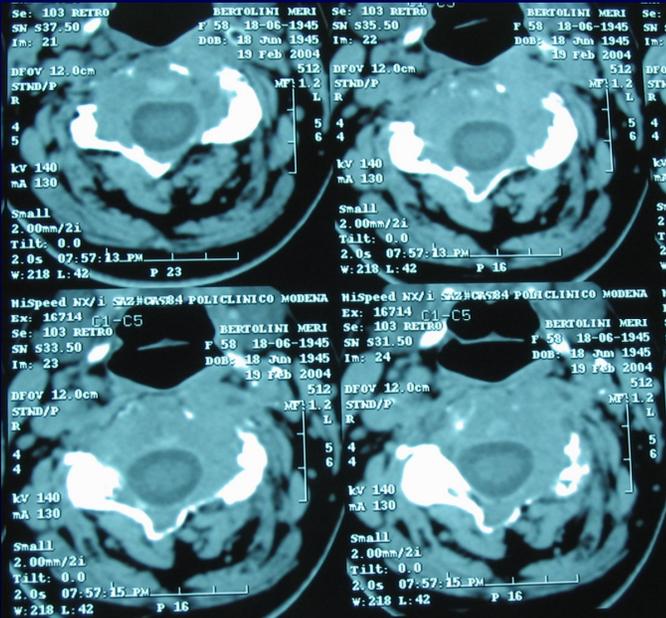

Mieloma cervicale

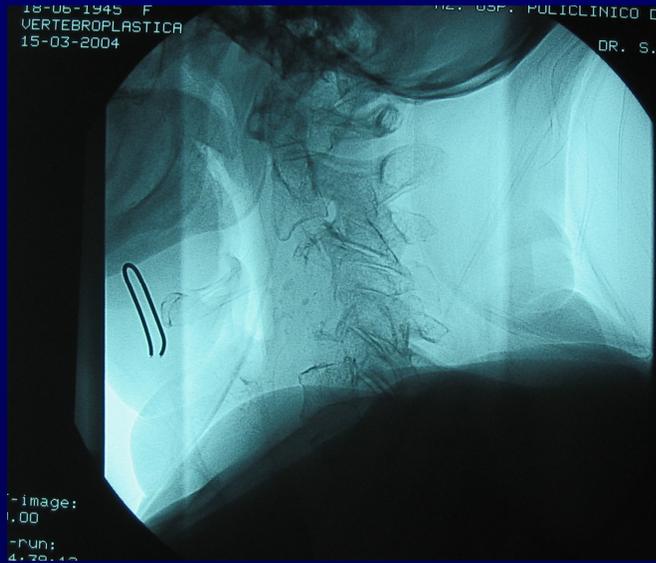

Controllo a 4 mesi



intraforaminale



21/10/1020

12000

F
18

120 KV

F
4

[L]

[R]

IONE
/2002
72998

20 KV

[L]

[R]

SP: 28
ST: 3.
512x51
C53
W411

SP: 28.0mm

ST: 3.0mm

512x512

C53


W411

TEMS
PACE

...MEDICAL SYSTEMS

CTPACE

[A]

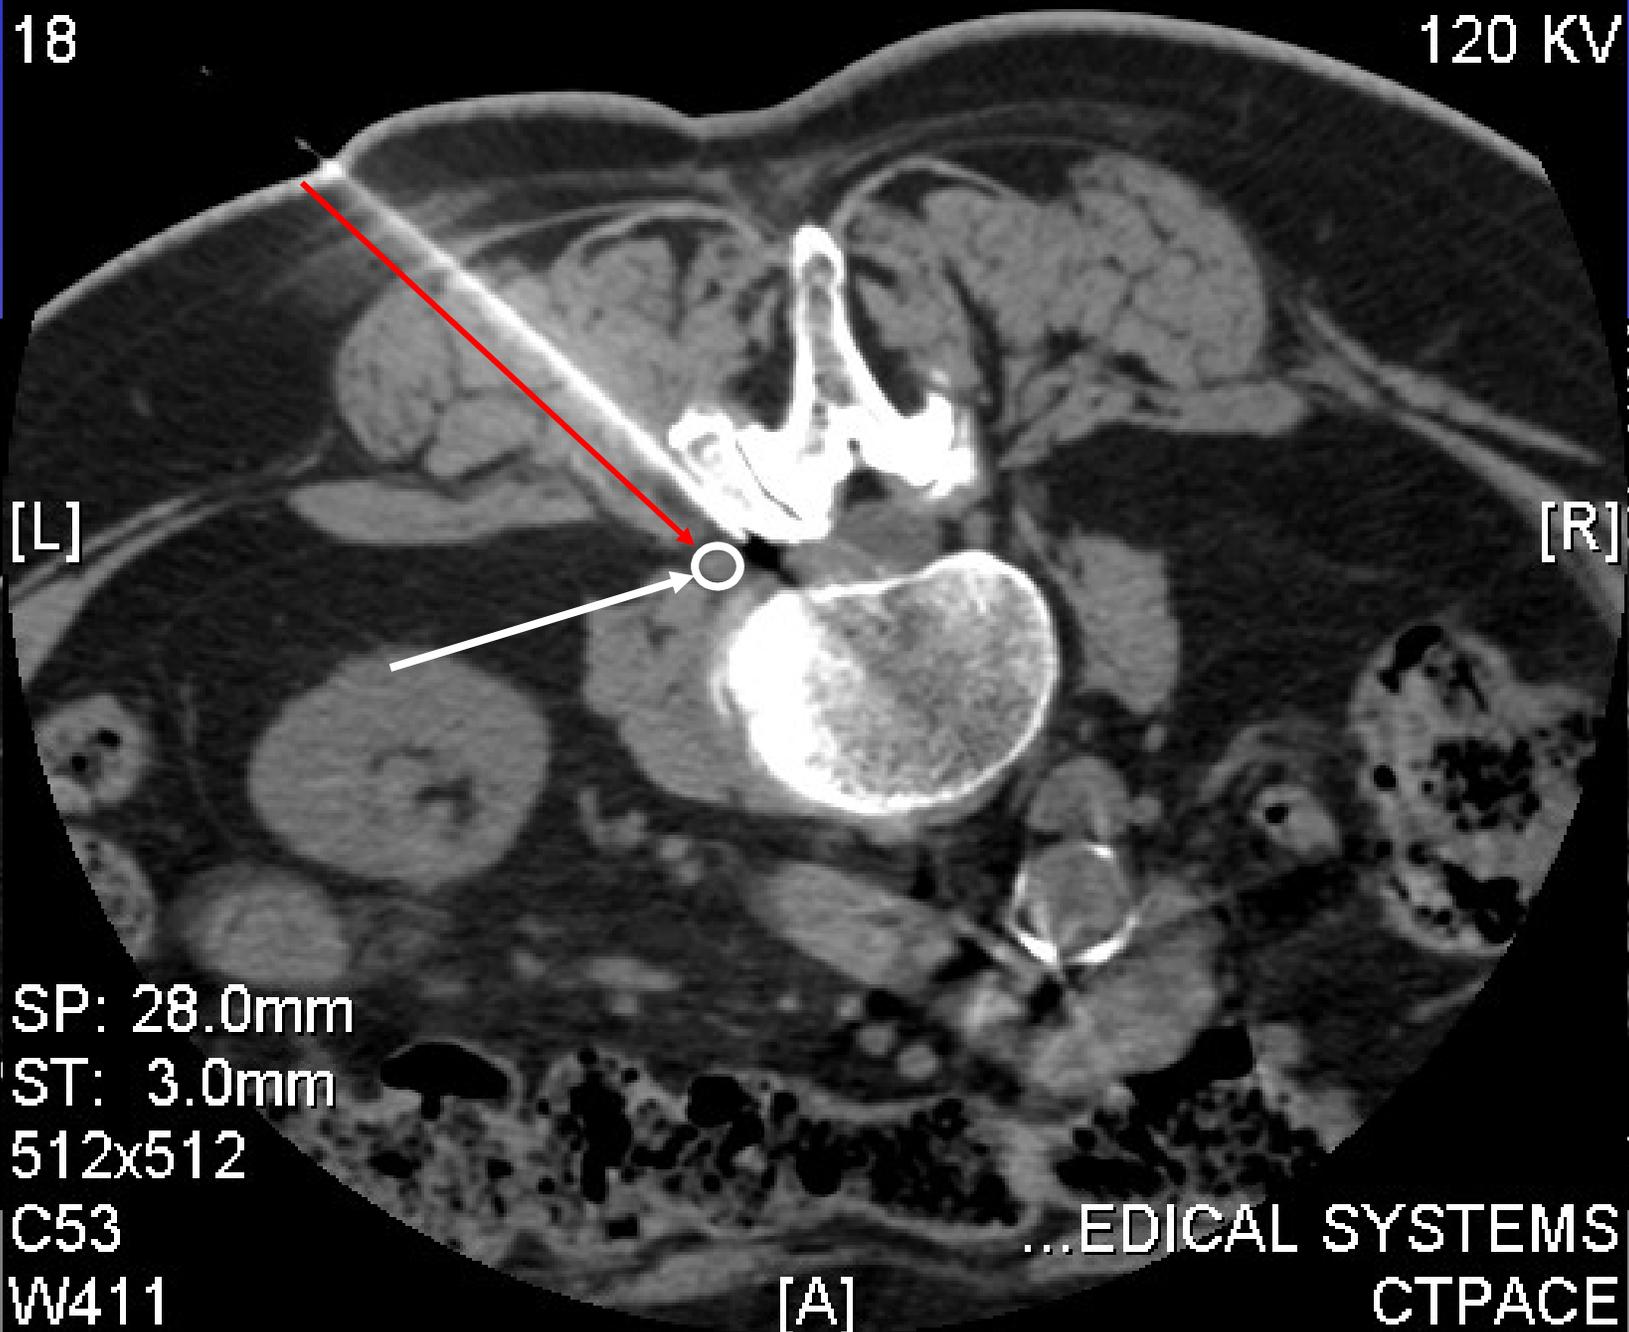



Modena 19 ottobre 2016

Grazie per l'attenzione

Dott.S. Vallone

**NEURORADIOLOGIA
AUSL MODENA**

